




## Fusión de la articulación sacroilíaca (Sistema de fusión SI Rialto™)

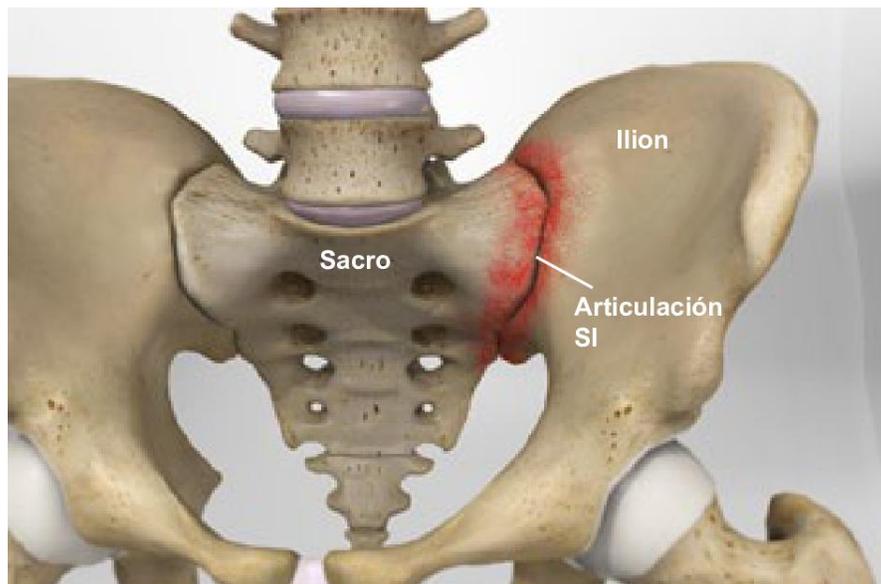

### Descripción general

Si usted tiene dolor debido a una articulación sacroilíaca dañada o enferma (le llamamos articulación "SI"), una fusión podría resultar de ayuda. Con el sistema de fusión SI Rialto, su cirujano utiliza implantes de titanio para unir el hueso ilion de la cadera, con el hueso sacro de la columna vertebral. Es posible que esto alivie el dolor asociado con la disfunción de la articulación SI o la enfermedad de la articulación SI.

### Preparación

Para comenzar, se le administra un medicamento para dormirlo o para bloquear la sensibilidad en su articulación SI. Se le posiciona boca abajo. El cirujano hace una pequeña abertura en su piel. Con la ayuda de un dispositivo de rayos x que muestra imágenes de vídeo, llamado "fluoroscopio", se introduce un clavo guía en su articulación SI. El cirujano utiliza un método que minimiza el contacto con sus músculos.

### Procedimiento

A la vez que protege sus tejidos blandos, el cirujano perfora con cuidado un canal a lo largo de este clavo. Pasa por el ilion, a través de la articulación SI y llega hasta adentro del sacro. Se inserta el implante Rialto, que une con seguridad ambos huesos. Se necesitarán uno, dos o tres implantes para estabilizar su articulación. Con el tiempo, crecerá nuevo hueso sobre los implantes, alrededor de ellos y a través de la articulación, creando una fusión sólida.

### Fin del procedimiento

Cuando el procedimiento esté concluido, se le mantendrá en observación. Dependiendo de sus necesidades, es posible que le permitan regresar a casa o que deba permanecer en el hospital toda la noche. Su médico le dará instrucciones para ayudar a su recuperación.

Rialto™ SI Fusion System es una marca comercial registrada de Medtronic, el cual no ha autorizado, patrocinado ni de otro modo aprobado este contenido.

© 2020 Swarm Interactive. La duplicación no autorizada está estrictamente prohibida.